

DOM ZDRAVLJA "Zvezdara"

Mesto: Beograd, Olge Jovanović br. 11

Broj: 4586/2

Datum: 22.12.2017.

Redni broj javne nabavke: AI-8/2017

PORTAL JAVNIH NABAVKI

PREDMET: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, partija broj 2-zatvoreni sistem za uzimanje venske krvi, JN broj AI-8/2017,

Dana 21.12.2017 godine, zainteresovano lice se obratilo zahtevom broj 4586/1, za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, partija broj 2-zatvoreni sistem za uzimanje venske krvi, JN broj AI-8/2017.

Pitanje:

1. Partija br.2-stavka br.1-da li je moguće ponuditi jedan automatski čitač sedimentacije sa 100 mesta, čija je mogućnost rada 250 ESR analiza na sat?

Odgovor naručioca:

Naručilac poseduje dve laboratorije.

Laboratorije se nalaze u centralnom delu Domu zdravlja "Zvezdara" i Domu zdravlja "Zvezdara"-Ogranak Mirjevo, tako da je neophodno da se obezbede dva automatska čitača sedimentacije. Svaki od čitača mora imati najmanje 60 mesta, kako je i navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Naručiocu nije prihvatljivo da ponuđač ponudi samo jedan čitač sedimentacija.

Pitanje:

2. Partija br.2-stavka br.7-dali je prihvatljivo ponuditi mikro tubu sa K EDTA od 0,2ml ili 0,5ml, pored 0,25ml, kako je traženo konkursnom dokumentacijom, i samim tim omogućite većem broju ponuđača da učestvuju u ovom postupku javne nabavke?

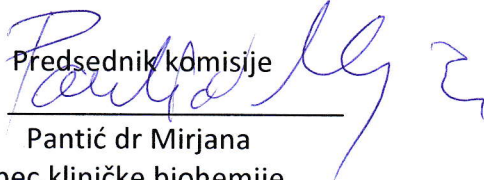
Odgovor naručioca:

Naručilac je u specifikaciji konkursne dokumentacije za stavku broj 7 naveo MIKRO TUBA SA K EDTA 0,25ml, ali ako potencijalni ponuđač u svojoj ponudi ponudi mikro tube od 0,2ml takva ponuda će biti prihvaćena od strane naručioca.

Mikro tube sa K EDTA od 0,5ml su neprihvatljive za naručioca.

S poštovanjem

Predsednik komisije


Pantić dr Mirjana
Spec.kliničke biohemije